
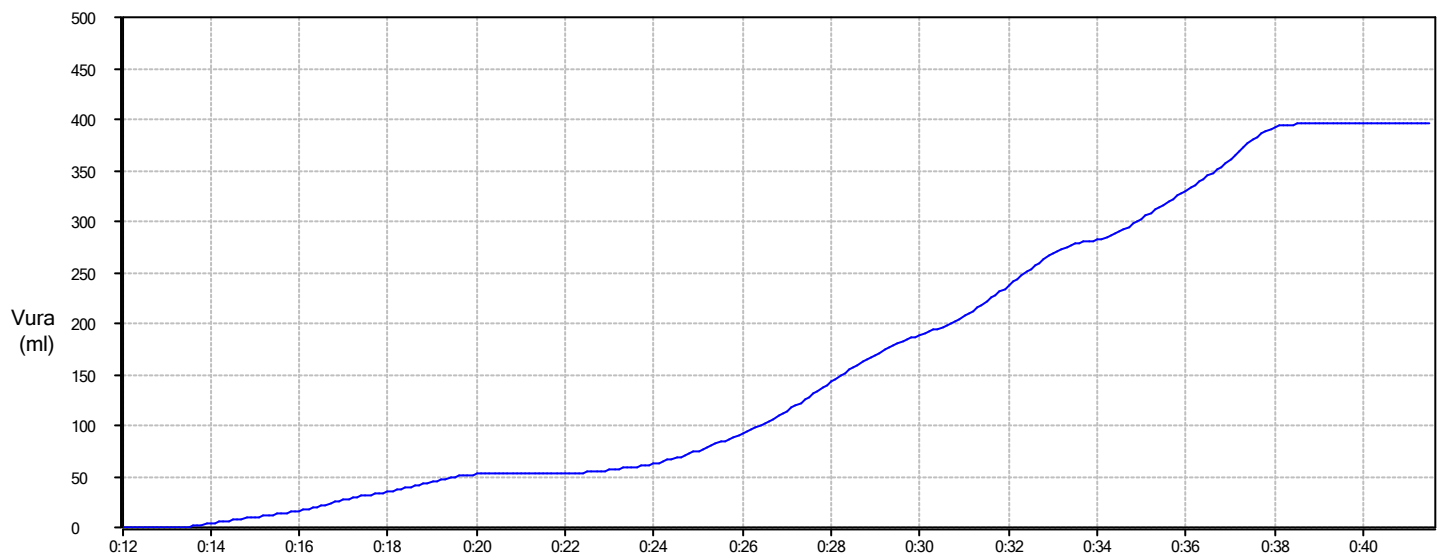


Urinflödesmätning

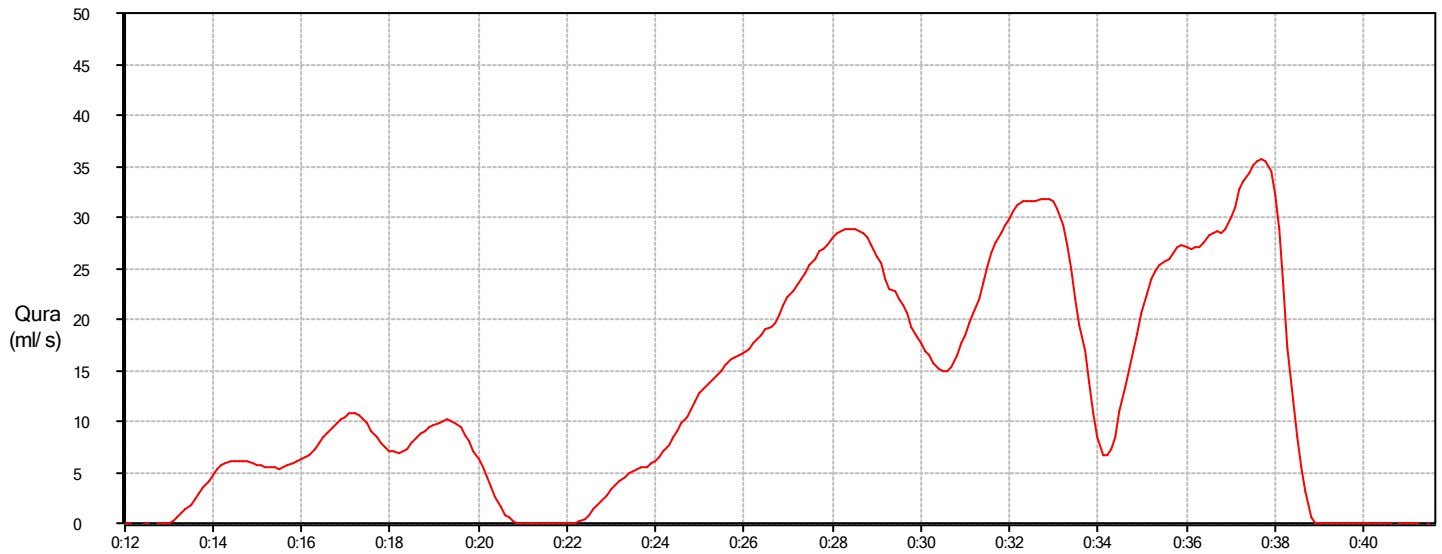

Medelflöde: 15,8 ml/s 73%
 Max flöde: 35,7 ml/s 125%
 Mikterad volym: 397 ml
 Tid till Qmax: 0:25 min:sek
 Flödestid: 0:25 min:sek
 Miktionstid: 0:26 min:sek
 Fördröjningstid: 0:13 min:sek

Patient:

Kommentarer:
